


CAIET SARCINI IN VEDEREA ACHIZITIONARII UNUI ANALIZOR
SEMIAUTOMAT PENTRU DETERMINAREA COAGULARII PLASMATICE,

conform Anunt de publicitate SEAP nr. 117892

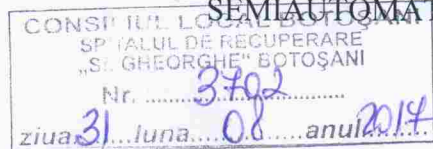

SPECIFICATIILE TEHNICE - ANALIZOR SEMIAUTOMAT PENTRU
DETERMINAREA COAGULARII PLASMATICE:

- performanta: 60 teste PT/ora; 60 teste fibrinogen/ora; 20 teste APTT/ora;
- restrictii: dedicat testelor clasice, coagulometrice (teste cromogene indisponibile);
- operare: manuala;
- canale de masurare: 2 canale de masurare cu capac de protectie pentru lumina si praf; protectie impotriva luminii externe; traseu pentru pipetarea optima folosind varfuri Eppendorf;
- principiu de masurare: turbodensitometric, opto-mecanic cu ajustare automata a sistemului optic si agitatori magnetici pentru omogenizarea suspensiei si cresterea sensibilitatii de masurare;
- volumul cuvei de reactie: 150-225 microlitri;
- calibrare: introducerea manuala a punctelor curbei de calibrare, in functie de metoda; kit de calibrare pe 6 nivele pentru PT si fibrinogen;
- control intern de calitate: pe 2 nivele, normal si patologic, cu trasarea automata a diagramelor Levey Jennings;
- software: incarcat in memorie;
- metode programate: incarcate din soft, in limba romana;
- curba de calibrare: programabila cu maxim 9 puncte de calibrare;
- sursa de lumina: LED, ajustarea intensitatii luminii, conform turbiditatii plasmei;
- consumabile: cuve de reactie; agitatori magnetici; hartie termica;
- conditii de operare: temperatura de 10-30 gr. Celsius; umiditate < 85%, fara condensare.

Analizorul trebuie sa fie insotit, la punerea in functiune, de urmatoarele documente:

- Avizul de la Ministerul Sanatatii privind punerea pe piata si service;
- Declaratia de conformitate conform marcajului CE;
- Autorizatia de service de la producator;
- Certificat ISO 13485 pentru producator;
- Certificat de calitate si garantie: minim 18 luni, anul fabricatiei analizorului: 2017.

Instalarea si punerea in functiune se va face la sediul beneficiarului de catre departamentul de service al firmei distribuitoare, fara nici un cost suplimentar.

Suport tehnic 24h din 24h, timp maxim de interventie: 24 de ore de la solicitare.

SEF LABORATOR ANALIZE MEDICALE,
CH. PR. RAILEANU MIRELA DANIELA



RAILEANU MIRELA-DANIELA
Chimist principal
Buciumul medical
Caf 310022